



Handleiding Zorgtraject Pharmawin

Augustus 2009

Corilus
Hogenakkerhoek 5
9150 Kruibeke

Tel. 03/253.20.20
Fax 03/253.20.40
pharma@corilus.be
www.corilus.be

1. ALGEMEEN

Voor het verwerken van voorschriften in het kader van een zorgtraject kan u in de afleveringsmodule op twee verschillende manieren tewerk gaan :

- U selecteert eerst het zorgtraject en vervolgens het product
- U selecteert / scant het product en antwoordt bevestigend op de vraag of deze aflevering al dan niet kadert binnen een zorgtraject.

De specifieke voorwaarden en richtlijnen gekoppeld aan elk zorgtraject worden opgevangen bij de twee werkwijzen zodat in beide gevallen het voorschrift correct verwerkt wordt.

2. EERSTE WERKWIJZE : SELECTIE VAN HET ZORGTRAJECT

Selectie van een zorgtraject is enkel mogelijk wanneer u aflevert op voorschrift voor een verzekerde patiënt (en is niet van toepassing op de categorie NIOO).

Maakt u in andere gevallen gebruik van de knop zorgtraject dan krijgt u onderstaande melding :



Na selectie van de (verzekerde) patiënt, klikt u bovenaan op de knop "Zorgtraject" (F6).

TEST ACTIEF ♀ N 59 Jaar
 000000000000 110/1.10 110/110 **X Niet best**
 20 : RIZIV Actief VS nr. : 849 SIS Niet klaar 27/07/09

Hoev	Naam	Bedrag	Wg	Stock	Min.	TB	LE	IB	EP	RIZIV
20:	Pre-Totaal :	0		0 F						

Specialiteit: [] Tegoedbon Moet SIS Moet Vs. Moet Attest 0 E

Aantal artikels :0 + ✓ ✗

In het volgende scherm worden een aantal lijsten getoond :

- De lijst met gedefinieerde zorgtrajecten
- De lijst met materialen gekoppeld aan het geselecteerde zorgtraject
- De lijst met geselecteerde producten
- En tenslotte onderaan de lijst met producten die in aanmerking komen en waaruit u het meest aangewezen product kan selecteren.

Diabetes : educatie en zelfzorg

Zorgtraject	Materiaalset	Hoefv.	Omschrijving	CNK
Diabetes : educatie en zelfzorg	Strips			
Diabetes : zorgtraject	Lancetten			
Nierinsufficiëntie : zorgtraject	Glucometer			

Naam	V	N	Prijs	V	CDE	Stock	rempe	Best.	LE	Plaats	Verv.	Wg	B	Kort.
1 FREESTYLE LITE TESTSTRIPS 50 7081 201			49.44			0	0	0						
2 GLUCOCARD X-SENSOR 50 34681			43.43			0	0	0					E	
3 GLUCOMEN LX SENSOR STRIPS 50 39553			43.43											
4 ONE TOUCH ULTRA TESTSTRIPS 50 02032005			42.85			1	0	1	AD		10/09		E	
5 ONE TOUCH VITA TESTSTRIP 2X25 02187401			42.85											
6 PRECISION XTRA PLUS ELEKTRODE 50 9881 846			49.44											

CNK: 2449064 Act. Prijs: Pr. VUIGW
Labo: ABBOTT DIABETES CARE

Na selectie van het zorgtraject, ziet u in de lijst "Materiaalset" welk product of producten in aanmerking komen voor vergoeding binnen het traject.

Bv. binnen het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie kan u enkel een bloeddrukmeter selecteren.

De productlijst geeft de gebruikelijke gegevens weer : prijs, stock, bestelinfo, plaatscode ...

Onderaan verschijnen ook telkens de remgelden voor de geselecteerde lijn.

Selecteren kan door te dubbelklikken op de gewenste lijn of door enter te drukken na selectie van de lijn. Om een reeds geselecteerd product te verwijderen, klikt u in het kader rechtsbovenaan op de lijn (de geselecteerde lijn wordt geel) en drukt u vervolgens op Delete.

Diabetes : educatie en zelfzorg

Zorgtraject	Materiaalset	Hoefv.	Omschrijving	CNK
Diabetes : educatie en zelfzorg	Strips	2	ONE TOUCH VITA TESTSTRIP 2X25 02187401	2549046
Diabetes : zorgtraject	Lancetten	1	ONE TOUCH LANCETTEN ULTRASOFT 100 02049201	1705516
Nierinsufficiëntie : zorgtraject	Glucometer			

Wijzigt u van zorgtraject nadat reeds producten werden geselecteerd, wordt de vraag gesteld of deze mogen verwijderd worden zodat u opnieuw de gewenste producten kan kiezen voor het nieuw geselecteerde zorgtraject.

The screenshot shows a software window titled 'Selectie specialiteit' with a sub-header 'Diabetes : educatie en zelfzorg'. Below this is a table with columns: Zorgtraject, Materiaalset, Hoev., Omschrijving, and CNK. The first row is highlighted in blue: 'Diabetes : educatie en zelfzorg', 'Strips', '1 GLUCOCARD GLUCOJECT LANCETS 100 394', and '2544393'. Below this is another table with columns: Naam, V, N, Prijs, V, CDE, Stock, rempe, Best., LE, Plaats, Verv., Wg, B, Kort. The second row is highlighted in blue: '2 GLUCOCARD GLUCOJECT LANCETS 100 394', '10.43'. A dialog box is overlaid on the table with the text: 'Er zijn reeds producten voor "Diabetes : educatie en zelfzorg" verkocht. Producten verwijderen?' and buttons for 'Ja' and 'Nee'.

2.1. Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie

Na selectie van het zorgtraject Nierinsufficiëntie, selecteert u de bloeddrukmeter en bevestigt u deze selectie door te klikken op het groene vinkje. In aflevering wordt de bloeddrukmeter verrekend en wordt automatisch het bijhorende honorarium geregistreerd.

Is de basisprijs van de bloeddrukmeter lager of gelijk aan 60€ dan betaalt de patiënt niets. Is deze hoger dan betaalt de patiënt een supplement (zie voorbeeld hieronder).

TEST ACTIEF	♀ N	59 Jaar	LEJEUNE PHILIPPE	16265118340
00000000000000	110/1.10	110/110	✗ Niet best.	
20 : RIZIV Actief		VS nr. : 852	SIS Niet klaar	27/07/09

Hoev.	Naam	Bedrag	Wg	Stock	Min.	TB	LE	IB	EP	RIZIV
1	TENSOVAL DUO CONTROL 1 9002051	7.55		-1	0	0		C	60.00	W V
1	HONORARIUM ZORGTRAJECT NIERINSUFF	0	AP						15.00	A
20:	Pre-Totaal :	7.55		305 F						

2.2. Zorgtraject diabetes

Voor diabetes maakt men onderscheid tussen twee zorgtrajecten nl. :

- *Zorgtraject diabetes* : de patiënt ontvangt een pakket bestaande uit :
 - 3 verpakkingen van 50 strips
 - 1 verpakking van 100 lancetten
 - Eventueel 1 glucometer
- *Programma zelfzorg en educatie* : de patiënt ontvangt een pakket bestaande uit :
 - 2 verpakkingen van 50 strips
 - 1 verpakking van 100 lancetten
 - Eventueel 1 glucometer

Na selectie van het juiste zorgtraject ziet u in de lijst "Materiaalset" alle strips, lancetten en glucometers die in aanmerking komen. Binnen de 3 types van materiaal kiest u telkens het af te leveren product : **automatisch zal het maximum toegelaten aantal worden opgenomen** aangezien volgens de reglementering de apotheker het geautoriseerde materiaal **in één keer** dient af te leveren.

Bv. Voor een voorschrift in het kader van het Zorgtraject diabetes :

- Selecteer binnen de lijst van de strips een product (dubbelklik of klik + enter) :
3 stuks verschijnen automatisch in het kader rechts boven
- Selecteer binnen de lijst van lancetten het gewenste product :
Automatisch zal 1 stuk worden opgenomen
- Selecteer tot slot binnen de lijst van glucometers de gewenste meter :
Ook hier wordt automatisch 1 stuk opgenomen.
U hoeft nu enkel de selectie te bevestigen via de groene vink.

Diabetes : zorgtraject			
Zorgtraject	Materiaalset	Hoev. Omschrijving	CNK
Diabetes : educatie en zelfzorg	Strips	3 GLUCOMEN LX SENSOR STRIPS 50 39553	2549863
Diabetes : zorgtraject	Lancetten	1 GLUCOCARD GLUCOJECT LANCETS 100 394	2544393
Nierinsufficiëntie : zorgtraject	Glucometer	1 TERUMO FINETOUGH KIT	2438794

Welke gegevens verschijnen nu in de aflevering ?

Aangezien de tarifiering van het materiaal en het honorarium verlopen op basis van specifieke **verstrekingscodes**, worden in de aflevering automatisch de afgeleverde producten vertaald naar deze **te tarifieren codes**. De reële CNK's van de afgeleverde producten worden eveneens opgenomen zodat de stock voor de producten kan worden aangepast.

Hoev.	Naam	Bedrag	Wg	Stock	Min.	TB	LE	IB	EP	RIZIV
3	GLUCOMEN LX SENSOR STRIPS 50 39553	0		-6	0	0		C	43.43	A
1	HONORARIUM MATERIAAL ZORGTRAJECT	0	AP						8.48	A
1	MATERIAAL ZORGTRAJECT DIABETES	0	AP	0	0	0			75.35	A
1	GLUCOCARD GLUCOJECT LANCETS 100 394	0		-2	0	0		C	10.43	A
1	TERUMO FINETOUGH KIT	0		-2	0	0		C	58.38	A
1	HONORARIUM GLUCOMETER ZORGTRAJECT	0	AP						5.83	A
1	GLUCOMETER ZORGTRAJECT DIABETES	0	AP	0	0	0			22.17	A
20:	Pre-Totaal :	0		0	F					

Bij afsluiten van de verkoop worden alle gegevens in herzien weggeschreven op het voorschriftnummer : enkel de verstrekingscodes zullen in het tarifieringsbestand worden opgenomen. Er wordt dus een vast honorarium toegekend per materiaalset.

3. TWEDE WERKWIJZE : SELECTIE VAN HET PRODUCT.


Levert u op voorschrift een geautoriseerd product af zonder via de knop Zorgtraject te passeren, dan zal Pharmawin u vragen of deze aflevering al dan niet kadert binnen een zorgtraject (en in het geval van diabetes welk type) :

Bij verkoop van een bloeddrukmeter wordt deze vraag gesteld :



- Ja : brengt u in het scherm Zorgtraject. U bevestigt via de groene vink. Wenst u in dit scherm alsnog een ander type bloeddrukmeter te selecteren, dan schrapt u eerst de reeds opgenomen lijn via 'delete' en selecteert in de lijst de andere bloeddrukmeter.
- Nee : de bloeddrukmeter wordt afgerekend aan de in de fiche opgenomen publieksprijs.

Bij verkoop van een verpakking teststrips of een glucometer komt volgend selectiekader:

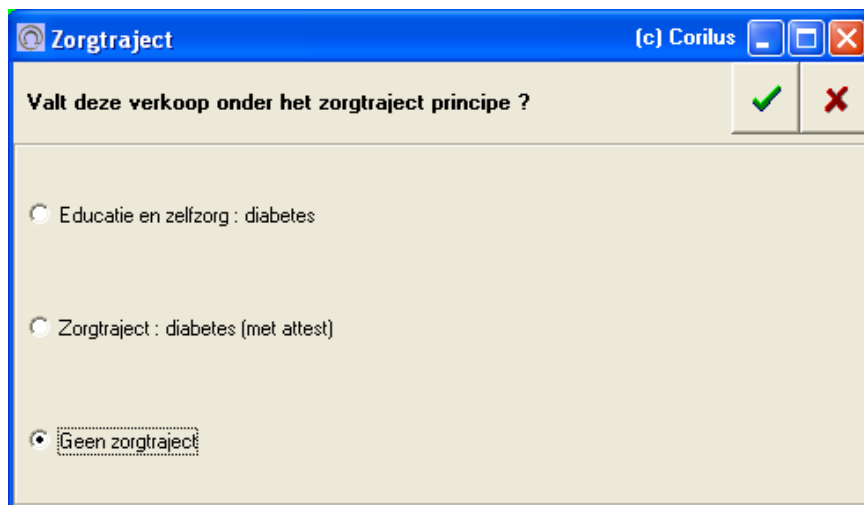

- Geen zorgtraject : het product wordt aan de normale publieksprijs afgeleverd.
- Selectie van een van de zorgtrajecten: brengt u in het scherm zorgtraject waar de gescande strips met het maximum toegelaten aantal reeds is opgenomen. U hoeft dan enkel nog de lancetten en eventueel de glucometer toe te voegen.

Na bevestigen via de groene vink, worden net als in de werkwijze via de knop Zorgtraject, de nodige codes geregistreerd.

4. WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN EEN ZORGTRAJECT VERKOOP

Indien er nog een aanpassing moet gedaan worden aan een zorgtraject verkoop, moet deze gedaan worden in het zorgtraject scherm.

Om vanuit de aflevering terug in het zorgtraject scherm te geraken (al dan niet in herzien-wijzigen), selecteert u opnieuw de knop 'Zorgtraject' F6.

Daar kunt u de gewenste aanpassingen doen in het kader rechtsbovenaan, door op de gewenste lijn te klikken en vervolgens op Delete te drukken, of in het onderste gedeelte nieuwe producten te selecteren.

Zorgtraject	Materiaalset	Hoev.	Omschrijving	ONK
Diabetes : educatie en zelfzorg	Bloeddrukmeter	1	OMRON BLOEDDRUKMETER M3 INTELLISENSE AUTOMAT_ARM	2270783
Diabetes : zorgtraject				
Nierinsufficiëntie : zorgtraject				

Verlaat het scherm na de wijzigingen met de groene vink om deze bevestigen.

Indien u toch probeert om in aflevering een lijn te schrappen die behoort bij een zorgtrajectverkoop, zal u de volgende melding krijgen:

